


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЛУКОВИТ
телефон: +359 697 5 24 64
факс: + 359 697 5 20 14
e-mail: lukovit_ob@yahoo.com



REPUBLIC OF BULGARIA
MUNICIPALITY OF LUKOVIT
phone: +359 697 5 24 64
fax:: +359 697 5 20 14
e-mail: lukovit_ob@yahoo.com

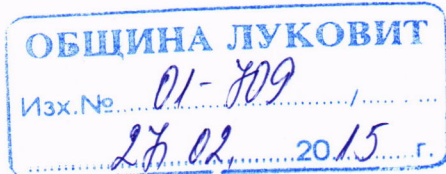

ДО
Участниците в открита процедура по
ЗОП „Доставка, монтаж и въвеждане
в експлоатация на медицинско
оборудване в рамките на проект
„Преустройство и оборудване на
МБАЛ- гр. Луковит”

Относно: Отговор на въпроси на участниците в Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване в рамките на проект „Преустройство и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение - гр. Луковит“, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 с договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-05/2011/014

Вх.№ 02-1169/ 25.02.2015 год.

Въпрос 1: В техническата спецификация на фиброколоноско в ОП2 има допуснатата техническа грешка при изписването на работната дължина на фиброколоноскопа, като се има предвид, че дължина от 130 до 200 мм (13-20см) би била твърде малка за оглед на колоната?

Отговор: Да, в техническата спецификация има допуснатата техническа грешка. Работната дължината на фиброколоноскопа да се чете от 1300мм до 2000мм.

Въпрос 2: В техничаското описание на дуплекс доплер на доплерова сонография в ОП 2 фигурира изискването: „Сонден депендиант: Конвексен: 18 стъпков, Линеен: 14 стъпков“. Молим за разяснение и уточнение по горесцитираното изискване: какво следва да се разбира под „сондев депендиант“ и за какъв тип стъпки се касае (честотни или други)?

ОТГОВОР: „Сонден депендиант” следва да се разбира „В зависимост от трансдюсера”
Стъпките са в сантиметри и се отнасят до дълбочината на изобразяване, всяка стъпка е един сантиметър.

Въпрос 3: Какви трнасдюсери (сонди) следва да се включат в окомплектоването на доплера за доплерова сонография (ОП2)?

ОТГОВОР: В окомплектовката на апарата трябва да е включен един конвексен трансдюсер за абдоминални прегледи.

С уважение,
Кмет на Община Луковит



Иван Грънчаров/