


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЛУКОВИТ
телефон: +359 697 5 24 64
факс: + 359 697 5 20 14
e-mail: lukovit_ob@yahoo.com



REPUBLIC OF BULGARIA
MUNICIPALITY OF LUKOVIT
phone: +359 697 5 24 64
fax: +359 697 5 20 14
e-mail: lukovit_ob@yahoo.com

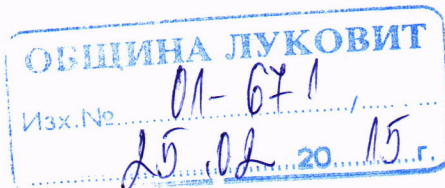

ДО
Участниците в открита процедура по
ЗОП „Доставка, монтаж и въвеждане
в експлоатация на медицинско
оборудване в рамките на проект
„Преустройство и оборудване на
МБАЛ- гр. Луковит”

Относно: Отговор на въпроси на участниците в Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване в рамките на проект „Преустройство и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение - гр. Луковит“, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 с договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-05/2011/014

Вх.№ 02-1111/ 23.02.2015 год.

Въпрос № 1- Относно показател ПЗ- Технически предимства „Методика за оценка на офертите и показатели за комплексна оценка и тяхната относителна тежест“

В документацията е посочено, че офертата с предложен най- висок сбор точки от изброените технически параметри получава максимален брой точки – 20 т.

При събиране на максималния брой точки, който може да се получи от всеки участник, крайният резултат е 19 т., а не 20 т.

В параметър 2. „Предложена увеличена мамография“ – максималния брой точки 5т е допуснатата техническа грешка, а именно „Участник, предложил мамограф с възможно най-голямо увеличение - получава 4 т., би трябвало да получава 5 точки.


ОТГОВОР: В Решение за промяна № 82/ 24.02.2015 год. са отразени корекции относно показател ПЗ – по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2. Решението за промяна може да се запознаете и в „Профил на купувача“ на Община Луковит.

Въпрос № 2 Относно раздел V. Технически спецификации на медицинското оборудване, предмет на поръчката, по обособена позиция № 1 – Компютърен томограф: относно параметър 14. Непрекъсваемо захранване (UPS).

Моля да потвърдите, че изискваният по спецификация UPS е интегриран в апарата и служи да гарантира запаметяване на започнатото изследване.

ОТГОВОР: Изискваният по спецификация UPS следва да осигури непрекъсваемо захранване, поддържащо и предпазващо основната електроника на апарата, позволяващо трансферирането и запаметяването на последните придобити образни данни, както и извършването на нормалните процедури по сигурното извеждане на пациента чрез поддържане на движението на масата. Разположението на UPS зависи от предложението на участника.

С уважение,
Кмет на Община Луковит



/Иван Грънчаров/